

博爱校医室医疗器械采购合同

采购人（甲方）：周口市红十字会

供应商（乙方）：河南九州通东泰科技有限公司

签订地点：河南周口市

项目名称：周口市红十字会博爱校医室医疗物资和办公设备采购项目（1包）

项目编号：周财招标采购-2026-44

财政委托号：(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 甲方购买乙方商品如下：

乙方按照本合同约定，向甲方供应校医室全套医疗物资，共计 79 套，共包含以下物资：

类别	序号	品名	单位	数量
器械类	1	CPR 模拟人	套	79
	2	诊察床	张	79
	3	床头柜	个	79
	4	治疗手推车	台	79
	5	折叠轮椅	台	79
	6	高压消毒锅（18L）	台	79
	7	贮槽（高压消毒锅装消毒物品用）	个	79
	8	对数灯光视力表	个	79
	9	纸质视力表	个	79
	10	验光串镜片	套	79
	11	超声波身高体重测量仪	台	79
	12	担架	副	79
	13	床单	个	158
	14	急救箱（含急救包）	个	79
	15	课桌椅测量尺	把	79

	16	纱布罐	个	79
	17	肺活量计	个	158
	18	一次性吹口	个	31600
	19	血压计（水银）	个	79
	20	血压计（电子）	个	79
	21	听诊器	支	79
	22	叩诊锤	个	79
	23	额式红外体温计（电子）	个	79
	24	受水器	个	79
	25	敷料镊（≥14cm）	套	158
	26	敷料镊（≥16cm）	套	158
	27	敷料镊（≥18cm）	套	158
	28	手术剪（直尖≥16cm）	套	158
	29	手术剪（直尖≥18cm）	套	158
	30	不锈钢镊子筒（1大1小）	套	79
	31	不锈钢方盘(1大1小)	套	79
	32	不锈钢消毒盘（1大1小）	套	79
	33	垃圾桶	个	79
	34	医用垃圾桶	个	79
	35	雾化器	台	79
	36	移动紫外线消毒车	台	158
	37	简易呼吸器（成人）	台	79
	38	五官检查器	台	79
	39	血糖仪	台	79
耗材类	40	绷带（3列）	套	790
	41	绷带（4列）	套	790
	42	消毒纱布块	包	158
	43	消毒棉签	包	158
	44	消毒棉球	包	158
	45	胶布	盒	79
	46	骨折固定夹板（肘、膝、腕、踝关节、锁骨、前臂、颈托）	套	79
	47	冰毯	盒	79
	48	医用垃圾袋	包	79
	49	白大褂	套	79
合同总价款（大小写）：壹佰肆拾壹万捌仟伍佰伍拾柒圆壹角捌分（1418557.18元）				
备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务等费用。				

备注：乙方根据甲方需求完成 Logo 印制。

第二条产品的技术标准（包括质量要求）

乙方应在投标文件中声明提供的货物及安装技术标准严格执行国家及行业标准。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

1.所有医疗器械须符合国家医疗器械标准，为全新正品，在有效期内，无破损、无质量缺陷。若出现有毒有害、假冒伪劣、翻新、贴牌等现象，或因为质量问题给甲方及第三方造成损害的均由乙方独立承担责任，并赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于经济损失、声誉损失。

2.医疗器械须随货提供：产品注册证、生产许可证、合格证、检验报告等合法资质文件。

3.乙方保证所供 79 套物资规格、质量、数量完全一致，无差别供货。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：甲方指定的 79 处校医室地址（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3.产品的交货期限20 天。合同签订后 20 日内，按照甲方要求，完成 Logo 印制，乙方负责将上述货物安全、整洁的运输至甲方指定地址，运费等由乙方承担。乙方逾期交货的，每逾期一日，按合同总价款的 1%向甲方支付违约金；逾期超过 10 日的，甲方有权单方解除合同，乙方需按合同总价款的 20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍需补足。货物运输过程中的毁损、灭失风险由乙方承担。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：壹佰肆拾壹万捌仟伍佰伍拾柒圆壹角捌分（1418557.18 元）

第六条 付款条件

货物交付并经甲方验收合格后，乙方向甲方提供合同价款等额的发票，甲方收到发票履行必要审批手续后，通过银行转账方式，将合同总价 95%费用 1347629.32 元（大写：壹佰叁拾肆万柒仟陆佰贰拾玖圆叁角贰分）支付至乙方指定收款账户。预留合同总价 5%作为质量保证金，自货物验收合格之日起计算，质保期为 1 年。质保期满，无违约情形后，按财务流程一次性支付尾款 70927.86（大写：柒万零玖佰贰拾柒元捌角陆分）。

第七条 验收方法

- 1.乙方安装调试后，在 3 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
- 2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
- 3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。
- 4.甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

- 1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收

材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 3 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务

乙方对其所提供的货物免费保修 1 年，保修期从验收日期开始。质保期内提供免费上门服务，乙方应在接到报修通知后 3 天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

第十条不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十二条合同纠纷调处

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项

目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十三条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称周口市红十字会博爱校医室医疗物资和办公设备采购项目（1包）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 6 份，甲乙双方各执 3 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。



采购人（甲方）：（公章）
地址：周口市川汇区莲花路人大政协综合楼 10 楼
法定代表人：韩卫东
委托代理人：
电话：
开户银行：中国工商银行周口分行营业部开
账号：1717020509049015238
2026 年 9 月 29 日



供货人（乙方）：（公章）
地址：河南省郑州市中原区官渡街道华山路 220 号
4 号楼一层 A-1066、A-1018
法定代表人：刘安林
委托代理人：施瑞 42
电话：0371-58604979
户银行：中国光大银行股份有限公司郑州分行
账号：52100188100098119
2026 年 9 月 29 日

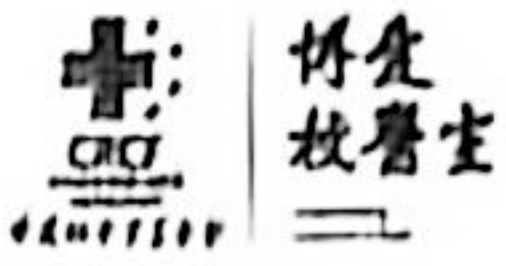
货物需求及技术规格参数

1 包

序号	品名	单位	数量	标准	管理类别	备注
1	*CPR 模拟人（初高中配成人）	套	79	1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观； 2.模拟生命体征： 初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动，瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 3.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 4.三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。 方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。 方式二：模式考核，在设定的时间内，根据 2015 国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数 30：2 的比例，完成 5 个循环操作。 方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 5.控制器显示屏电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数； 6.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量； 7.条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml； 8.条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm； 9.可自行设定操作时间，以秒为单位。 10.操作频率：2015 标准为至少 100 次/分，也可自行设定数值。 11.电源状态：采用 220V 电源，经过稳压器稳压后输出电源 12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。） 12.操作结束后可以打印操作过程。 13.产品材质：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料； 14.符合美国心脏学会（AHA）2015 国际心肺复苏&心血管急救（ECC）指南更新	-	

2	诊察床	张	79	1.框架材质：1.0 不锈钢； 2.床面材质：配重体海绵、无毒环保优质革面； 3.床面载重量≥180Kg； 4.焊接：整体使用氩弧焊工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，经过加细抛光处理； 5 表面光滑，平整、无毛刺，易清洁消毒，有效防止细菌滋生； 6.用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。不包括口腔科检查和诊断；	I	
3	床头柜	个	79	1.主体材质：1.0 不锈钢； 2.焊接：整体使用氩弧焊工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，经过加细抛光处理； 3.表面光滑，平整、无毛刺，易清洁消毒，有效防止细菌滋生；		
4	治疗手推车	台	79	1.主体材质：1.0 不锈钢； 2.焊接：整体使用氩弧焊工艺焊接而成，焊缝均匀，结合牢固，经过加细抛光处理； 3.表面光滑，平整、无毛刺，易清洁消毒，有效防止细菌滋生；	—	
5	折叠轮椅	台	79	1. 通常由车轮、座椅、扶手、脚踏板等组成； 2. 以乘坐者手驱动、脚踏驱动或护理者手推为动力； 3. 用于行动障碍患者转运、行走功能补偿； 4. 手推把手防滑、易于推拉； 5. 配软座垫，柔软舒适； 6. 车身配有伫立刹车和安全带，利于安全出行； 7. 免充气橡胶轮，抗震性能好； 8. 踏板采用抱箍式踏板锁紧装置，稳定牢固 9. 坐高≥50cm，坐宽≥46cm ，背垫高≥46cm；重量≥19KG； 10.符合 GB/T 13800-2009 手动轮椅车	II	
6	高压消毒锅（18L）	台	79	1.全不锈钢材料； 2.容积≥18L； 3.电热加热方式； 4.用于耐湿耐热医疗器械的灭菌； 5.符合 YY 0504-2016 手提式蒸汽灭菌器；	II	
7	贮槽（高压消毒锅装消毒物品用）	个	79	1.产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2.符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3.通过 SGS 检测；		

8	对数灯光 视力表	个	79	1.通常由视力表（卡）和照明装置组成。照明装置为直接照明或后照明（视力表灯）； 2.用于视力检测或弱视、盲视筛查； 3.工作环境温度：5℃～40℃； 4.工作环境相对湿度：≤80%； 5.工作环境大气压力：80kPa～106kPa； 6.使用电源：交流 220V、50Hz 7.材质：上下框为电泳铝合金型材；面板为进口亚克力透光面板； 8.面板左边印有 5m、标准对数视标（E），右边印有红绿试验视标、worth 四点试验视标、放射状散光试验视标、斑点、状散光试等辅助视标 9.视力表的印制符合 GB11533 的要求	I	
9	纸质视力 表	个	79	1. 喷印清晰； 2. 设有高危险、警戒线和正常视力；		
10	验光串镜 片	套	79	1. 主要由正、负球镜验光镜片组成； 2. 镜片符合 GB 11614-2009 要求；		
11	超声波身 高体重测 量仪	台	79	1. 液晶高清 7 寸触摸彩屏显示，分辨率不低于 480*800； 2. 铝合金机身，超强耐磨防滑 ABS 踏板； 3. 精工高速热敏打印机，核心元器件原装进口； 4. 体重测量参数要求： 体重测量范围：1-300kg 分度值≥0.1kg 误差范围：+ 0.1 测量系统：电阻应变式 5. 身高测量参数要求： 身高测量范围：60-200cm 分度值：0.1cm 误差范围：+ 0.5 测量系统：超声波非触碰式测量 6. 电源电压：AC110-220（50Hz/60Hz） 7. 额定功率：≤ 36W		
12	担架	副	79	1. 担架长度≥2200mm； 2. 用于医疗机构运送、移动患者用； 3. 担架承受最大静载荷 135Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象； 铲式担架承受最大静载荷为 160Kg 而不损坏；		
13	床单	个	158	1. 涤平面料； 2. 绣博爱校医室 logo；		

14	急救箱（含急救包）	个	79	1. 能放置常用药品以及清创护理、止血、包扎固定物品； 2. 箱体铝合金材质； 3. 用于急救时出诊使用； 4. 箱体喷印博爱校医室 logo	-	
15	课桌椅测量尺	把	79	1. 三节装置。由身高测量尺和课桌椅测量尺两部分构成。身高测量尺刻有身高尺寸和身高号，测量范围 0~200cm。课桌椅测量尺刻有桌高号和椅高号； 2. 用于课桌椅调整；	-	
16	纱布罐	个	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测；		
17	肺活量计	个	158	1. 功能：测量人体肺活量值用； 2. 量程：10000ml； 3. 分度值：5ml； 4. 精度：1%F. S(气体容积以当时状态计)； 5. 使用电源：通过专用稳压器接 AC220V±10%外接电源； 6. 正常工作温度最高值：40℃； 7. 湿度最高值：90%； 8. 大气压力范围：80~106kPa； 9. 符合 GB/T19851. 12-2005；		
18	一次性吹口	个	31600	1. 一次性塑料制品；		
19	血压计（水银）	个	79	1. 标尺双刻度显示:kPa 和 mmHg 两种读数 2. 测量范围:0~40kPa (0~300mmHg) 3. 小的分度值为 0. 5kPa (2mmHg) 4. 基本误差:± 0. 5kPa (3. 75mmHg)		
20	血压计（电子）	个	79	1.通常由阻塞袖带、传感器、充气泵、测量电路组成。采用示波法、柯式音法或类似的无创血压间接测量原理进行血压测量的电子设备； 2.特大液晶数字显示，液晶尺寸≥ 75mm*73mm； 3.壁带适用≥22cm，壁带宽度> 15cm； 4.压力准确度:3mmHg； 5.脉搏数:5%以内； 6.需具备自动关机功能； 7.符合 YY 0670-2008 无创自动测量血压计；	II	
21	听诊器	支	79	1. 通常由拾音器、信号处理模块和耳机组成。对收集的声音进行（频率）非线性放大； 2. 用于收集和放大从心脏、肺部、动脉、静脉和其他内脏器官处发出的声音； 3. 符合 YY/T 1035-2021 听诊器	I	

22	叩诊锤	个	79	1. 不锈钢材质; 2. 带测量刻度; 3. 用于配合普通外科、神经科诊断时敲打、刺激人体;		
23	额式红外 体温计(电子)	个	79	1. 测量精度:35-42℃内, ±0.2℃; 35-42℃外, ±0.3℃; 2. 用于临床测量患者体温, 通常放置于人体额头、手腕部位测量; 3. 该符合 GB/T 21417.1-2008 非接触式电子体温计标准;	II	
24	受水器	个	79	1. 透光性好, 使用方便; 2. 环保材质; 3. 主要用于眼部一次性清洗使用, 安全卫生;		
25	敷料镊	套	158	1. 不锈钢材质; 2. 可用消毒仪器消毒灭菌后重复使用; 3. 表面无锋棱、毛刺、裂纹现象; 4. 具有良好的耐腐蚀性和夹取功能; 5. 镊体长度≥14cm;	I	
26	敷料镊	套	158	1. 不锈钢材质; 2. 可用消毒仪器消毒灭菌后重复使用; 3. 表面无锋棱、毛刺、裂纹现象; 4. 具有良好的耐腐蚀性和夹取功能; 5. 镊体长度≥16cm;	I	
27	敷料镊	套	158	1. 不锈钢材质; 2. 可用消毒仪器消毒灭菌后重复使用; 3. 表面无锋棱、毛刺、裂纹现象; 4. 具有良好的耐腐蚀性和夹取功能; 5. 镊体长度≥18cm;	I	
28	手术剪(直尖)	套	158	1. 不锈钢材质; 2. 可用消毒仪器消毒灭菌后重复使用; 3. 剪刀螺钉闭合或打开时不应有跟动、咬口或卡住现象; 4. 具有良好的耐腐蚀性和剪切功能; 5. 剪刀表面无锋棱、毛刺、裂纹; 6. 剪刀长度≥16cm;	II	
29	手术剪(直尖)	套	158	1. 不锈钢材质; 2. 可用消毒仪器消毒灭菌后重复使用; 3. 剪刀螺钉闭合或打开时不应有跟动、咬口或卡住现象; 4. 具有良好的耐腐蚀性和剪切功能; 5. 剪刀表面无锋棱、毛刺、裂纹; 6. 剪刀长度≥18cm;	II	
30	不锈钢镊子筒	套	79	1. 产品材质: SUS304 不锈钢板材; 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定; 3. 通过 SGS 检测; 4. 筒身尺寸≥60*155mm;		

31	不锈钢镊子筒	套	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测； 4. 筒身尺寸≥45*110mm；		
32	不锈钢方盘	套	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测； 4. 盘身尺寸≥310*240*30mm；		
33	不锈钢方盘	套	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测； 4. 盘身尺寸≥260*200*30mm；		
34	不锈钢消毒盘	套	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测； 4. 盘身尺寸≥290*190*55mm；	-	
35	不锈钢消毒盘	套	79	1. 产品材质：SUS304 不锈钢板材； 2. 符合 GB/T11170-2008 不锈钢多元素含量的测定； 3. 通过 SGS 检测； 4. 盘身尺寸≥200*110*48mm；		
36	垃圾桶	个	79	1.金属或塑料，容积≥18L； 2.用于盛装办公垃圾；	—	
37	医用垃圾桶	个	79	1. 黄色 PP 材质，容积≥30L，安全环保无异味，开合方式为脚踏式带盖结构； 2.用于装废弃的医疗垃圾，带警示标志；	-	
38	雾化器	台	79	1. 喷雾速率>0. 2ml/min 2. 噪音音≤65dB 3. 电源 220V 50Hz 4. 无油压缩泵，雾化颗粒细腻，剂量可调，静音，高效散热		
39	移动紫外线消毒车	台	158	1. 通常由紫外线灯管、控制系统等组成。工作原理是利用紫外线灯管发出的紫外线，对医疗器械表面进行照射，使病原微生物灭活； 2. 用于不耐热且耐受紫外线的医疗器械的消毒 3. 使用电源：AC220V 50Hz； 4. 输入功率：160VA； 5. 带定时功能，定时范围：0～120min，其最大定时误差≤10min；	II	

41	简易呼吸器（成人）	台	79	1. 通常由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），从而实现向患者肺部通气的复苏装置； 2. 用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气 符合 YY/T 0600.4-2013 医用呼吸机基本安全和主要性能专用要求第 4 部分：人工复苏器 或 GB 8982-2009 医用及航空呼吸用氧	II	
42	五官检查器	台	79	1. 通常由检查镜头、目镜和手柄、灯泡、辅助撑开装置组成； 2. 用于外耳道和鼓膜的检查	I	
43	血糖仪	台	79	1、检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血； 2. 用于校准的样品类型：静脉血浆； 3. 用量≤0.7uL； 4. 测试范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L (20mg/dL-600mg/dL)； 5. 血糖测试时间≤6 秒； 6. 记忆容量≥10 个； 7. 使用频率≥2.5 万次；		
44	绷带（3 列）	套	790	1. 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤； 2. 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用； 3. 纱布绷带在 365nm 紫外线灯下不应显强蓝色荧光：单位面积重量应不低于 58g/m；径向断裂强力应不小于 85N，纬向断裂强力应不小于 60N；	I	
45	绷带（4 列）	套	790	1. 通常为纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。部分具有弹力或自粘等特性。非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤； 2. 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用； 3. 纱布绷带在 365nm 紫外线灯下不应显强蓝色荧光：单位面积重量应不低于 58g/m；径向断裂强力应不小于 85N，纬向断裂强力应不小于 60N；	I	

46	消毒纱布块	包	158	1. 通常为由医用脱脂棉纱布或脱脂棉与粘胶纤维混纺纱布经过裁切、折叠、包装、灭菌步骤加工制成的敷料； 2. 主要适用于医院、医务室的外科手术及家庭保健等的一次性吸血、敷药用； 3. 纱布块切割边不外露； 4. 医用纱布块无菌。环氧乙烷残留量应不大于 10mg/kg； X 射线可探测组件(带 X 线型适用)不应脱落纤维，不应影响纱布块的柔软性，单位质量不小于 0.5g/m，具有 X 射线不透性；	II	
47	消毒棉签	包	158	1. 无菌棉签是以医用脱脂棉为原材料，缠绕于洁净的竹棒上而成； 2. 竹棒表面应光滑、粗细均匀，整体无色斑、污点及异物，棉头洁白、大小均匀，应为柔软而富有弹性的白色纤维，无色斑、污点及异物，无臭、无味。在紫外灯下观察，不应显强蓝色荧光。竹棒与棉头的分离强度不低于 0.5N； 3. 棉签应无菌，环氧乙烷残留量不大于 10mg/kg； 4. 符合医用脱脂棉 YY/T0330-2015；		
48	消毒棉球	包	158	1. 为了方便使用，部分产品有供手持的组件。与酒精、碘伏等消毒剂搭配使用，无菌提供，一次性使用； 2. 用于临床上对皮肤创面进行消毒处理； 3. 脱脂棉球符合医用脱脂棉 YY/T0330-2015 中 3.1 的性状要求，水中可溶物的总量应不大于 0.50%；每克产品的吸水量应不小于 23g；下沉时间应不超过 10s；水中可溶物的总量应不大于 0.50%；醚中可溶物的总量应不大于 0.50%；干燥失重应不大于 8.0%；硫酸盐灰分应不大于 0.40%；在紫外灯下观察不应显强蓝色荧光； 4. 产品应无菌，环氧乙烷残留量不大于 10mg/kg；	II	
49	胶布	盒	79	1.通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤； 2.用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位 符合 YY/T 0148-2006 医用胶带 通用要求	I	
50	骨折固定夹板（肘、膝、腕、踝关节、锁骨、前臂、颈托）	套	79	1. 一般采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料、铝合金、石膏粉、纱布、非织造布等制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接； 2. 用于骨折或软组织等损伤的外固定； 3. 配备整理袋，且整理袋绣博爱校医室 logo；	I	
51	冰毯	盒	79	1. 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分； 2. 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织创面的降温； 3. 规格尺寸≥100*60cm；	I	

				4. 冰芯含量 2 连体 $\geq$ 10 个;		
52	医用垃圾袋	包	158	1.材质: PE 材质; 2.承重力强, 无惧撕拉硬扯拽, 韧性伸展性好; 3.安全标识油墨印刷, 安全无异味, 清晰耐磨耐刮, 印刷均匀;	-	
53	白大褂	套	79	1. 由涤纶或纯棉材质制成, 耐穿耐磨, 可洗涤后重复使用; 2.用于医护人员穿着的外衣, 普通白大褂起到防尘作用, 抗菌抗病毒白大褂能避免细菌繁殖, 降低再次传播风险 3.绣博爱校医室 logo; 4. 每套含短袖 1 件、长袖 1 件, XL 码	-	